



Rüsch
Laryngoskope
Umfassende Lösungen

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in Forschung und Innovation hat sich Teleflex dem Fortschritt der Anästhesiepraxis durch stetige Verbesserung der Atemwegsmanagement-Technologie verschrieben.

Zusammen
Verbess
Anästhe

125

Jahre Herstellung von
medizinischen Anästhesie-
und Atemwegsinstrumenten
in deutscher Qualität

427 Patente für
Atemwegshilfen



Alle 3 Sekunden wird
irgendwo auf der Welt
ein LMA Airway
verwendet*

jährlich bei Intubationen
verwendete Teleflex-
Produkte**

> 25 m



> 12.000 Ärzte werden
jährlich in den
Fortbildungsprogrammen
von Teleflex geschult

Visualisierung


Low profile



* Daten liegen vor

** Vertriebsdaten zu Teleflex Global Anesthesia, YOY, Dez. 2017

Arbeit für die Verbesserung der Anästhesiepraxis

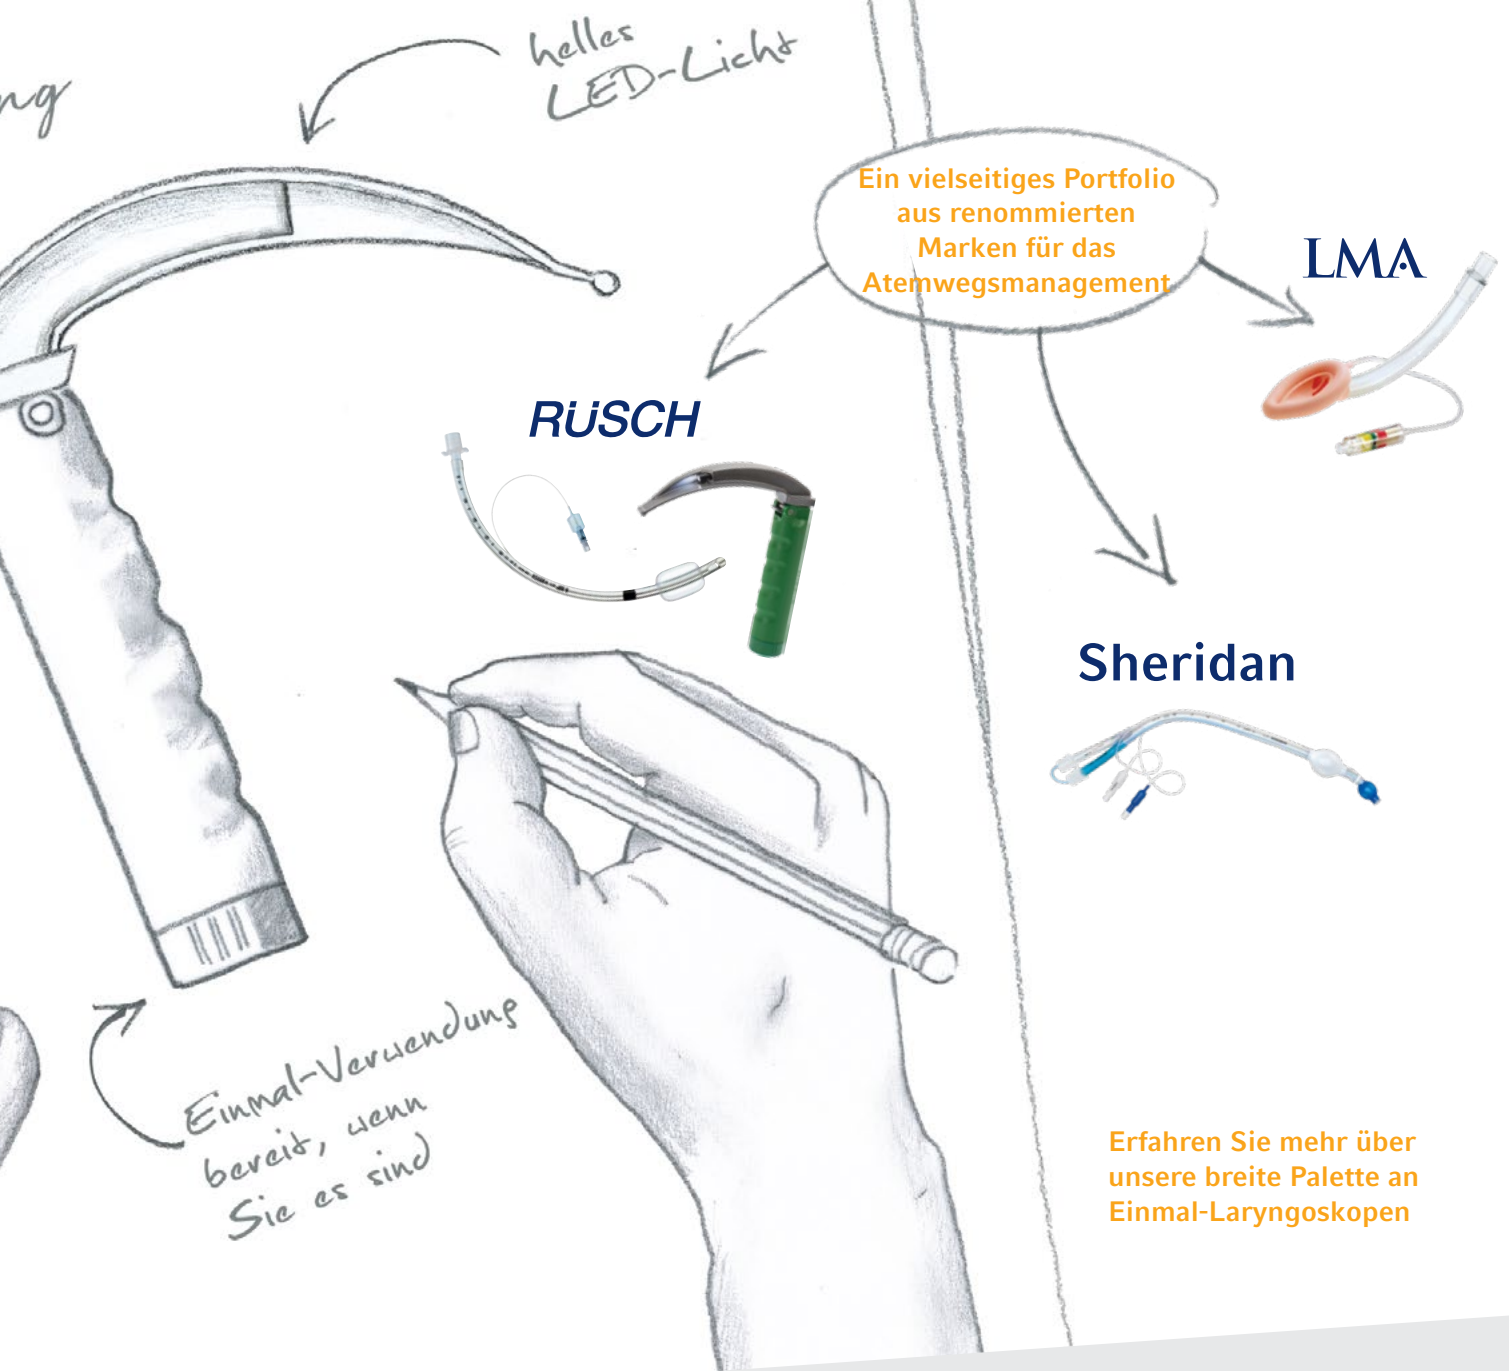

Erfahren Sie mehr über unsere breite Palette an Einmal-Laryngoskopen

Inhaltsverzeichnis

Eine Komplettlösung zur Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination 05

Fiberoptik-Systeme

Einwegprodukte

Einweg-Spatel

Rüsch Polaris Einweg-Laryngoskopspatel	06
Rüsch GreenLite Metallspatel	08
Rüsch Safeview Metallspatel.	09
Rüsch Metallspatel mit beweglicher Spitze	10

Einweg-Handgriff

Rüsch DispoLED Handgriff	11
------------------------------------	----

Wiederverwendbare Produkte

Wiederverwendbare Spatel

Rüsch Maxlite Metallspatel	12
Rüsch SnapLight Metallspatel	13

Wiederverwendbare Handgriffe


Rüsch LED Handgriff	15
Rüsch GreenLED Handgriff	16
Rüsch GreenSpec Xenon Handgriff	17

Spezialprodukte

Rüsch TruLite Secure Handgriff-Spatel-Kombination	18
Rüsch MRT-Sets	19

Zubehör & Index	21
---------------------------	----

Teleflex bietet eine breite Palette von Laryngoskopen an, einschließlich Lösungen für das Management schwieriger Atemwege und zur Verbesserung der Verfahrenseffizienz. Alle Spatel sind kompatibel mit ISO 7376 konformen Handgriffen für Fiberoptik-Systeme. Alle Handgriffe sind kompatibel mit ISO 7376 konformen Spateln für Fiberoptik-Systeme.



Eine Komplettlösung zur Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination

Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Reinigung von zur Intubation verwendeten Instrumenten sind gewachsen, da Bakterien resistenter werden und kein perfektes Dekontaminationsverfahren existiert.¹ Obwohl die meisten Bedenken hinsichtlich der Laryngoskop-Reinigung aufgrund des Patientenkontakts auf den Spatel gerichtet sind, werden die Handgriffe immer Besorgnis erregender, da Studien gezeigt haben, dass Handgriffe ebenfalls Bakterien tragen.²

Einweg-Laryngoskopspatel

Suboptimale Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Handhabung von wiederverwendbaren Laryngoskopspateln sind Faktoren, die mit dem potenziellen Risiko einer Kreuzkontamination verbunden sind.^{3,4} Studien mit wiederverwendbaren Laryngoskopspateln zeigen mikrobielle Kontaminationsraten von 57 - 93 %, ^{3,5} wobei 20 - 77 % der Spatel positiv auf okkultes Blut oder Proteinreste getestet wurden.^{4,6}

Teleflex bietet eine Reihe von Einweg-Laryngoskopen an: Die **Rüsch Polaris**, **Rüsch GreenLite** und **Rüsch Safeview** Einweg-Laryngoskopspatel für Fiberoptiksysteme sind robust und aus Metall. Ihre Einwegkonzeption bietet eine kostengünstige* Lösung, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren.

Einweg-Handgriffe

Obwohl Laryngoskopgriffe während der Intubation normalerweise nicht mit der Mundschleimhaut in Kontakt kommen, können sie mit kontaminierten Spateln in Kontakt kommen, was eine Möglichkeit der Kreuzkontamination darstellt. In Studien wurde festgestellt, dass bis zu 86 % der Handgriffe trotz Low-Level-Desinfektion mit Blut oder Mikroorganismen kontaminiert waren.^{4,7,8} Die Joint Commission und die Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland (AAGBI) haben aufgrund dieser Gefahr Empfehlungen zur Desinfektion und Sterilisation von wiederverwendbaren Laryngoskopspateln und -griffen herausgegeben.^{9,10} Eine Alternative sind Laryngoskopgriffe zum Einmalgebrauch.

Der **Rüsch DispoLED** Einweg-Laryngoskopgriff von Teleflex ist zur einmaligen Verwendung bestimmt und kann dazu beitragen, das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern und die Kosten für die Wiederaufbereitung wiederverwendbarer Instrumente zu vermeiden.

Literaturhinweise:

- Galinski M, Adnet F, Tran D, et al. *Eur J Anaesthesiol.* 2003;20(9):731-735.
- Williams D, Dingley J, Jones C, Berry N. *Journal of Hospital Infection.* 2010;74(2):123-128.
- Lowman W, Venter L, Scribante J. Bakterielle Kontamination wiederverwendbarer Laryngoskopspatel im Lauf der täglichen Anästhesiepraxis (Bacterial contamination of reusable laryngoscope blades during the course of daily anaesthetic practice). *S Afr Med J.* 2013;103(6):386-389.
- Phillips RA, Monaghan WP. Inzidenz von sichtbarem und okkultem Blut an Laryngoskopspateln und -griffen (Incidence of visible and occult blood on laryngoscope blades and handles). *AANA J.* 1997;65(3):241-246.
- Negri de Sousa AC, Vilas Boas VA, Levy CE, Pedreira de Freitas MI. Laryngoskope (Laryngoscopes): Auswertung der mikrobiellen Belastung von Spateln (Evaluation of microbial load of blades). *Am J Infect Control.* 2016;44(3):294-298.
- Miller DM, Youkhana I, Karunaratne WU, Pearce A. Vorhandensein von Proteinablagerungen auf „gereinigten“ wiederverwendbaren Anästhesiegeräten (Presence of protein deposits on 'cleaned' re-usable anaesthetic equipment). *Anaesthesia.* 2001;56(11):1069-1072.
- Call TR, Auerbach FJ, Riddell SW, et al. Nosokomiale Kontamination von Laryngoskopgriffen: Herausforderung der aktuellen Richtlinien (Nosocomial contamination of laryngoscope handles: challenging current guidelines). *Anesth Analg.* 2009;109(2):479-483.
- Williams D, Dingley J, Jones C, Berry N. Kontamination von Laryngoskopgriffen (Contamination of laryngoscope handles). *J Hosp Infect.* 2010;74(2):123-128.
- Joint Commission. Laryngoskopspatel und -griffe – Reinigung, Desinfizierung und Lagerung dieser Geräte (Laryngoscopes Blades and Handles – How to clean, disinfect and store these device). 2011; https://www.jointcommission.org/standards_information/jcfaqdetails.aspx?StandardsFaqlId=1201&ProgramId=46. Zugriff 26. Februar 2017.
- Association of Anaesthetists of Great Britain, Ireland. Richtlinien (Guidelines): Infektionskontrolle in der Anästhesie (Infection Control in Anaesthesia). *Anaesthesia.* 2008;63(9):1027-1036.

*Die Kosteneffizienz kann aufgrund einer Reihe von Faktoren wie z. B. spezifische Märkte, Dienstleistungen und Tarife variieren.


Fiberoptik-Systeme



Rüsch Polaris Einweg-Laryngoskopspatel

Die Erscheinung eines wiederverwendbaren Spatels, kombiniert mit den Vorteilen eines Einweg-Spatels

Es gibt häufig Bedenken hinsichtlich der Leistung, und Beschaffenheit einiger Einweg-Laryngoskopspatel im Vergleich zu wiederverwendbaren Spateln.^{11,12} Der Polaris Laryngoskopspatel von Rüsch mit seiner soliden Metallkonstruktion räumt diese Bedenken aus dem Weg, denn hiermit hat der Anwender das Gefühl eines wiederverwendbaren Spatels, der den Komfort eines Einweg-Spatels bietet.



Metallspatel
Mit dem Gewicht und Gefühl eines wiederverwendbaren Spatels

Spatel mit matter Oberfläche
Reduziert die Lichtreflexion

Low-Profile-Spateldesign
Reduzierte Höhe zur besseren Visualisierung und zur Verringerung des Risikos von Zahnbeschädigungen

4,7-mm-Faseroptikkabel
Für bessere Lichtübertragung

Kompatibel mit FO/grünen System-Handgriffen

Einweg-Fiberoptik-Systeme

Rüsch Polaris Einweg-Laryngoskopspatel



- Metallspatel mit dem Gefühl eines wiederverwendbaren Spatels.
- Low-Profile-Spateldesign zur besseren Visualisierung und zur Verringerung des Risikos von Zahnbeschädigungen
- 4,7-mm-Fiberoptikkabel für bessere Lichtübertragung
- Farbkodierte Verpackung zur leichten Erkennung der richtigen Größe

Rüsch Polaris Einweg-Laryngoskopspatel

ART.NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	FARBCODIERUNG	STK.
Spatel nach Macintosh					
4150100	Mac 0	85,0	10,7	Pfirsich	10
4150110	Mac 1	94,5	9,9	Weiß	
4150120	Mac 2	111,0	13,0	Blau	
4150130	Mac 3	133,0	14,0	Gelb	
4150140	Mac 4	149,00	13,0	Rosa	
4150150	Mac 5	159,00	14,5	Dunkelgelb	
Spatel nach Miller					
4150003	Miller 000	60,0	7,0	Hellgrün	10
4150002	Miller 00	66,5	12,8	Beige	
4150001	Miller 0	78,0	12,8	Violett	
4150010	Miller 1	103,0	12,8	Orange	
4150020	Miller 2	154,0	13,5	Grau	
4150030	Miller 3	195,0	13,5	Grün	
4150040	Miller 4	205,0	19,0	Lavendel	

Einweg-Spatel

Rüsch GreenLite Metallspatel

- Robuste Edelstahlkonstruktion von der Spitze bis zur Basis für zuverlässige Leistung
- Die fokussierte Lichtübertragung ermöglicht eine effektive Visualisierung durch Minimierung der Lichtstreuung
- Einsatzbereit – ohne Kosten- und Zeitaufwand für die Sterilisierung
- Farbcodierte Verpackung zur leichten Erkennung der richtigen Größe
- Intuitiver „Klick“-Verriegelungsmechanismus für schnelles und zuverlässiges Anbringen



Rüsch GreenLite Einweg Fiberoptik Laryngoskopspatel aus Metall



ART.NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	FARBCODIERUNG	STK.
Spatel nach Macintosh					
004551000	Mac 0	84	9,5	Pfirsich	20
004551001	Mac 1	94	9,5	Weiß	
004551002	Mac 2	103	11,5	Türkis	
004551003	Mac 3	132	15	Gelb	
004551004	Mac 4	162	15	Rosa	
Spatel nach Miller					
004550010	Mill 00	68	12	Beige	20
004550000	Mill 0	78	11,5	Lila	
004550001	Mill 1	105	11,5	Orange	
004550002	Mill 2	158	14	Grau	
004550003	Mill 3	198	14	Grün	
004550004	Mill 4	208	14	Lavendel	

Rüsch Safeview Spatel mit Schutzhülle

- Aus robustem Edelstahl, um die Leistung und das Gefühl eines wiederverwendbaren Metallspatels nachzubilden
- Abgeschrägte Spatelspitze reduziert potenzielle Traumen für den Patienten
- Hohe Lichtübertragung liefert klar sichtbare Strukturen dank hervorragendem Kontrast und weißem Licht
- Jeder Spatel wird in einer individuellen Schutzhülle geliefert, die die Kontaminationsgefahr für Patient und Personal senkt. Sie schützt den Handgriff während und nach der Intubation vor Kontakt mit Sekret oder Blut.
- Einfach und einsatzbereit



Rüsch Safeview Einweg Fiberoptik Laryngoskopspatel mit Schutzhülle

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	STK.
Metallspatel						
	670150	<ul style="list-style-type: none"> • Macintosh • Zum Einmalgebrauch 	0	81	11,0	10
			1	90	11,0	
			2	100	12,5	
			3	130	14,5	
			4	155	14,5	
			5	175	15,0	
	670185	<ul style="list-style-type: none"> • Miller • Zum Einmalgebrauch 	00	65	10,0	10
			0	79	10,0	
			1	105	12,0	
			2	157	12,0	
			3	180	12,0	
			4	208	14,0	

Verwendung von Safeview Spateln mit Schutzhülle



1. Den Spatel mit dem Handgriff verbinden, während er sich noch in seiner Schutzhülle befindet. Hülle an der Anschlussseite halten und die perforierte Spitze abreißen.
2. Schutz für den Handgriff: Die Safeview-Hülle aufrollen und über den Handgriff schieben.
3. Nach abgeschlossener Intubation Hülle nach unten rollen und zurück auf den Spatel schieben und diesen entsorgen.

Rüsch Metallspatel mit flexibler Spitze

Für schwierige Intubationen

- Aus medizinischem Edelstahl
- Abgeschrägte Spitze zur Minimierung von Gewebetraumen
- Die Spatelspitze kann zur besseren Kontrolle in schwierigen Intubationsfällen eingestellt werden
- Spatel nach Macintosh



Rüsch Metallspatel hier mit DispoLED Einweg-Handgriff (s. Seite 11)

Rüsch Einweg Metallspatel Mit Flexibler Spitze

ART.NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	STK.
670130	MAC 3	135	15	5
670130	MAC 4	155	15	

Einweg-Handgriffe

Rüsch DispoLED Handgriffe

- LED-Lichtquelle
- Robuster, ergonomischer Handgriff für Komfort und bequeme Handhabung
- Lichtquellenprüfung vor dem Einsatz in versiegelter Verpackung
- Einsatzbereit – Mit 2 AAA-Alkalibatterien ausgestattet. Kein Kosten- und Zeitaufwand für die Sterilisierung.
- 3 Jahre Lagerfähigkeit
- Alle Handgriffkomponenten können nach der Entsorgung recycelt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren



DispoLED Handgriff hier mit Rüsch Polaris Einweg-Metallspatel (s. Seite 6-7)



Rüsch DispoLED Einweg Fiberoptik Laryngoskophandgriff

ART.NR.	GEWICHT (G)	HÖHE (CM)	DURCHMESSER (CM)	STK.
77700	73	12	2,8	20

Wiederverwendbare Spatel

Maxlite Metallspatel

- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit mattem Finish, um die Lichtreflexion zu reduzieren
- Im Spatel integriertes Glasfaserbündel, um eine leichte Reinigung und Dekontamination zu ermöglichen
- Hochwertige Glasfaserbündel für eine hervorragende Lichtübertragung



Macintosh



Miller

Maxlite Metallspatel

ART.NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	STK.
Spatel nach Macintosh				
671000-000003	MAC 0	82	10	1
671000-000010	MAC 1	93	10	
671000-000020	MAC 2	115	13	
671000-000030	MAC 3	135	14	
671000-000040	MAC 4	155	14	
671000-000050	MAC 5	176	14	
Spatel nach Miller				
671060-000002	MILL 00	65	11	1
671060-000003	MILL 0	80	11	
671060-000010	MILL 1	100	11	
671060-000020	MILL 2	152	13	
671060-000030	MILL 3	192	13	
671060-000040	MILL 4	207	15	

Rüsch SnapLight Metallspatel

- Wiederverwendbarer Metallspatel mit abnehmbarem FibreClip zur Verlängerung der Lebensdauer des Spatels und Senkung der Kosten
- Einfach zu handhabender Click on/Click off austauschbarer FibreClip - ohne Schrauben
- Medizinischer Edelstahl mit matter Oberfläche zur Reduktion von Lichtreflektion
- Integrierter Sauerstoffanschluss für Säuglingsgrößen erhältlich – Konstanter Sauerstofffluss für mehr Zeit bei der Intubation*



SnapLight Metallspatel

ART.NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	STK.
Spatel nach Macintosh				
002201000	Mac 0	81	9,5	1
002201100	Mac 1	90	9,5	
002202200	Mac 2	100	11,5	
002203300	Mac 3	130	15	
002204400	Mac 4	155	15	
002205500	Mac 5	173	15	
Spatel nach Miller				
004457700	OxiPort Mill 00	77	11,5	1
004458800	OxiPort Mill 0	88	11,5	
002200000	Mill 00	64	11,5	
002215000	Mill 0	75	11,5	
002216100	Mill 1	100	11,5	
002217200	Mill 2	155	14	
002218300	Mill 3	195	14	
002219400	Mill 4	205	14	

Ersatzteile (SnapLight CLIP)

ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
Spatel nach Macintosh		
002501000	MAC 0	2
002501100	MAC 1	
002502200	MAC 2	
002503300	MAC 3	
002504400	MAC 4	
002505500	MAC 5	
Spatel nach Miller		
002500000	MILL 00	2
002515000	MILL 0	
002516100	MILL 1	
002517200	MILL 2	
002518300	MILL 3	
002519400	MILL 4	

*Literaturhinweise:

Indian J Anaesth. 2017; 61(5):404-409. doi: 10.4103/ija.IJA_86_17.

Eine randomisierte Vergleichsstudie der Miller-Laryngoskopspatel im Vergleich zu OxiPort

Miller-Laryngoskopspatel für Intubationen bei Neugeborenen und Säuglingen (randomised comparative study of Miller laryngoscope blade versus OxiPort Miller laryngoscope blade for neonatal and infant intubations)

Erhältliche Sets

Unsere SnapLight-Spatel sind in einer Vielzahl von Set-Konfigurationen mit verschiedenen Handgriffen erhältlich:



SnapLight Sets mit GreenSpec Xenon Handgriff

ART.NR.	MAC 0	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	MAC 5	GREENSPEC XENON HANDGRIFF	MILLER 00	MILLER 0	MILLER 1	MILLER 2	MILLER 3	MILLER 4
4261/X		1	1	1	1		1 (mittel)						
4262/X			1	1	1		1 (mittel)						
4263/X							1 (mittel)	1		1	1	1	
4270/MX							1 (mini)	1	1	1			
4272/X			1	1	1		1 (mittel)		1				
4273/X			1	1	1		1 (mittel)			1			



SnapLight Sets mit GreenLED Handgriff

ART.NR.	MAC 0	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	MAC 5	GREENLED HANDGRIFF
4261/L		1	1	1	1		1 (mittel)
4262/GL			1	1	1		1 (mittel)

Wiederverwendbare Handgriffe

Rüsch LED Handgriff

- LED-Beleuchtung für genaue anatomische Visualisierung
- LED-Lebensdauer: ≥ 10.000 Stunden
- Geriffelte Handgriffe in 3 Größen verfügbar
- Energiequelle (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten):
Schmaler Handgriff: Zwei 1,5 V Alkalibatterien (AA)
Handgriff für Erwachsene: Zwei 1,5 V Alkalibatterien (C)
Kurzer Handgriff: Eine 3,0 V Lithium-Ionen-Batterie Typ CR-123



Fiberoptischer Laryngoskop-Handgriff aus Metall – wiederverwendbar

ART.NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G)	HÖHE (MM)	DURCHMESSER (MM)	STK.
671067	1	LED-Handgriff*, schmal	132	152	19	1
	2	LED-Handgriff*, Erwachsene	228	151	29	
	3	LED-Handgriff*, kurz	200	109	29	

* ohne Batterien

Wiederverwendbare Handgriffe

Rüsch GreenLED Handgriff

- LED-Beleuchtung - Die integrierte LED-Lampe bietet eine optimale Lichtleistung für eine exakte anatomische Visualisierung
- Innovatives zweiteiliges Design reduziert Inventarkosten
- Gepolsterte Handgriffummantelung – zur bequemen Handhabung für den Arzt
- 2 AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



GreenLED Handgriff

ART.NR.	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G)	HÖHE (MM)	DURCHMESSER (MM)	STK.
133300	GreenLED Handgriff, Medium	194	147	28	1



Ersatzteile

ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
42152100	Rüsch GreenLED Handgriffummantelung, Medium	1
42153200	Rüsch GreenLED Batterie-Einsatz, Medium	

Rüsch GreenSpec Xenon Handgriff

Handgriff:

- Xenon-Beleuchtung – bietet ein unvergleichlich helles Kaltlicht
- Geriffelte Handgriff-Hülse in 3 Größen verfügbar
- Energiequelle: (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
 Mini-Handgriff: Zwei 1,5 V Alkalibatterien (AA)
 Kurzer Handgriff: Zwei Alkalibatterien (AA-Zelle)
 Mittlerer Handgriff: Zwei Alkalibatterien (C-Zelle)



Rüsch GreenSpec Xenon Handgriff

ART.NR.	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G)	HÖHE (MM)	DURCHMESSER (MM)	STK.
004411100	GreenSpec Handgriff, mittel	196	146	28	1
004412200	GreenSpec Handgriff, mini	147	146	18	

Zubehör

ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
512501FO/6	Xenon-Lampe 2,5 V	6

Spezialprodukte

Ideal für OP-Intubationen, Notfallwagen und Notfallsituationen



Rüsch TruLite Secure Handgriff-Spatel-Kombination

Komplett entsorgbare Lösung, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren und die Wiederaufbereitungskosten zu sparen.

- Kompakt und leicht - geeignet für den Einsatz in OP, Notfallwagen, Atemweg-Kits und EMS-Taschen.
- Spatel aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten und abgeschrägter Spitze
- Ergonomischer Handgriff aus hochwertigem, verstärktem Kunststoff
- Helle blau-weiße LED-Quelle.
- 2 vorgeladene AAA-Batterien für den sofortigen Einsatz in Notfallsituationen.
- Batterien haben eine Lagerfähigkeit von 3 Jahren.

Zuverlässiger und bequemer Einsatz

Die Rüsch TruLite Secure Laryngoskop Handgriff-Spatel-Kombination zum Einmalgebrauch ist ein einteiliges Spatel- und Handgriffsystem, das das Inkompatibilitätsrisiko minimiert und eine Vielzahl von farbcodierten Spateln bietet, mit deren Hilfe Anwender die richtige Größe für ihre Patienten schnell identifizieren und auswählen können.

Rüsch TruLite Secure Laryngoskop Handgriff-Spatel-Kombination zum Einmalgebrauch

ART.NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	GEWICHT MIT BATTERIEN (G)	FARBCODIERUNG	STK.
SPATEL NACH MACINTOSH						
004671002	Mac 2	100	11,5	108	Türkis	10
004671003	Mac 3	130	15	125	Gelb	
004671004	Mac 4	157	15	135	Rosa	
SPATEL NACH MILLER						
004670010	Mill 00	64	11,5	97	Beige	10
004670000	Mill 0	75	11,5	98	Lila	
004670001	Mill 1	101	11,5	104	Orange	
004670002	Mill 2	155	14	125	Grau	
004670003	Mill 3	195	14	137	Grün	
004670004	Mill 4	205	14	141	Lavendel	

MRT-fähiges Laryngoskop-System

Rüsch MRT-System

Für die Intubation in der MRT-Umgebung

Für den Einsatz unter Magnetresonanzbedingungen unabhängig getestet und zertifiziert und zwar auf Magnetfeldwechselwirkungen bei 3,0 Tesla mit höchstem räumlichem Gradientenfeld von 720 Gauss/cm*.



Erhältliche Sets



- Brillantweißes Xenonlicht für zuverlässige Visualisierung
- Erkennbares Design in Gold und Schwarz reduziert das Risiko, dass inkompatible Geräte in die MRT-Umgebung gelangen.
- Spatel aus widerstandsfähigem Edelstahl mit austauschbarem, vergoldeten FiberClip Lichtleiter
- Handgriff besteht aus Edelstahlkopf, -kontakt und -federn sowie Aluminiumkorpus
- Kohlenstoff-Zink-Batterie für kostengünstige** MRT-Kompatibilität
- Inklusive 2 Batterien bei Sets mit 3 Spateln oder weniger.
- Inklusive 4 Batterien bei Sets mit 4 Spateln oder mehr.



Rüsch MRT-Sets

ART.NR.	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	LED-HANDGRIFF	MILLER 0	MILLER 1	MILLER 2	MILLER 3
SET MIT EINEM SPATEL									
5411M	1				1				
5412M		1			1				
5413M			1		1				
5414M				1	1				
5420M					1	1			
5421M					1		1		
5422M					1			1	
5423M					1				1
SET MIT MEHREREN SPATELN									
5442M		1	1	1	1	1	1		
005852300		1	1	1	1		1	1	1
5446M	1	1			1	1	1		
5449M		1	1	1	1				


* Die spezifischen MR-Bedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung

** Die Kosteneffizienz kann aufgrund einer Reihe von Faktoren wie z. B. spezifische Märkte, Dienstleistungen und Tarife variieren.

Ersatzteile - Spatel

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
	5240M	Rüsch MRT Spatel MAC 0	1
	5241M	Rüsch MRT Spatel MAC 1	
	5242M	Rüsch MRT Spatel MAC 2	
	5243M	Rüsch MRT Spatel MAC 3	
5244M	Rüsch MRT Spatel MAC 4		
	5250M	Rüsch MRT Spatel MILL 0	
	5251M	Rüsch MRT Spatel MILL 1	
	5252M	Rüsch MRT Spatel MILL 2	
	5253M	Rüsch MRT Spatel MILL 3	
	5254M	Rüsch MRT Spatel MILL 4	

Ersatzteile - Handgriffe

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
	5525M	Rüsch MRT Handgriff: mittel	1

Austauschbarer FibreClip

ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
524102M	Rüsch MRT Fiberclip MAC 1	2
524202M	Rüsch MRT Fiberclip MAC 2	
524302M	Rüsch MRT Fiberclip MAC 3	
524402M	Rüsch MRT Fiberclip MAC 4	
525002M	Rüsch MRT Fiberclip MILL 0	
525102M	Rüsch MRT Fiberclip MILL 1	
525202M	Rüsch MRT Fiberclip MILL 2	
525302M	Rüsch MRT Fiberclip MILL 3	
525402M	Rüsch MRT Fiberclip MILL 4	

Batterien

ART.NR.	BESCHREIBUNG	STK.
005853300	Rüsch 1er Pack MRT-Batterien	1
53102M	Rüsch 2er Pack MRT-Batterien	2

Zubehör

Hartbox

ART.NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE	LÄNGE	BREITE	GEWICHT	STK.
5992/7	Universalbox für bis zu 2 Handgriffe und 6 Spatel	48 mm	230 mm	267 mm	402g	1
5993/7	Universalbox für bis zu 3 Handgriffe und mehr als 6 Spatel	55 mm	280 mm	330 mm	578g	

Index

REF	PAGE	REF	PAGE	REF	PAGE	REF	PAGE	REF	PAGE
002200000	13	004411100	17	005852300	19	4273/X	14	5412M	19
002201000	13	004412200	17	005853300	20	442152100	16	5413M	19
002201100	13	004457700	13	133300	16	512501FO/6	17	5414M	19
002202200	13	004458800	13	150001	7	5240M	20	5420M	19
002203300	13	004550000	8	4150002	7	5241M	20	5421M	19
002204400	13	004550001	8	4150003	7	524102M	20	5422M	19
002205500	13	004550002	8	4150010	7	5242M	20	5423M	19
002215000	13	004550003	8	4150020	7	524202M	20	5442M	19
002216100	13	004550004	8	4150030	7	5243M	20	5446M	19
002217200	13	004550010	8	4150040	7	524302M	20	5449M	19
002218300	13	004551000	8	4150100	7	5244M	20	5525M	20
002219400	13	004551001	8	4150110	7	524402M	20	5992/7	21
002500000	13	004551002	8	4150120	7	5250M	20	5993/7	21
002501000	13	004551003	8	4150130	7	525002M	20	670000	12
002501100	13	004551004	8	4150140	7	5251M	20	670060	12
002502200	13	004670000	18	4150150	7	525102M	20	670130	10
002503300	13	004670001	18	42153200	16	5252M	20	670130	10
002504400	13	004670002	18	4261/L	14	525202M	20	670150	9
002505500	13	004670003	18	4261/X	14	5253M	20	670185	9
002515000	13	004670004	18	4262/GL	14	525302M	20	671000	12
002516100	13	004670010	18	4262/X	14	5254M	20	671060	12
002517200	13	004671002	18	4263/X	14	525402M	20	671067	15
002518300	13	004671003	18	4270/MX	14	53102M	20	77700	11
002519400	13	004671004	18	4272/X	14	5411M	19		

Teleflex ist ein weltweiter Anbieter von Medizintechnik, die dazu beiträgt, die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Auf unserer unermüdlichen Suche nach klinischen Herausforderungen, die noch einer Lösung bedürfen, setzen wir zielgerichtete Innovationen zum Nutzen der Patienten und Gesundheitsdienstleister ein. Mit unserem vielseitigen Portfolio bieten wir Lösungen in den Bereichen Gefäß- und interventioneller Zugang, Chirurgie, Anästhesie, Kardiologie, Urologie, Notfallmedizin und Beatmung. Die Teleflex-Mitarbeiter weltweit arbeiten mit der Gewissheit, durch ihre tägliche Arbeit wirklich etwas bewegen zu können. Weitere Informationen erhalten Sie unter teleflex.com.

Zur Teleflex-Familie gehören Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüschi, UroLift und Weck – renommierte Marken mit einem gemeinsamen Ziel.

Unternehmenssitz

Telefon +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regionalniederlassungen

USA: Telefon +1 919 544 8000, gebührenfrei 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Lateinamerika: Telefon +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Telefon +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland

Australien 1300 360 226

Belgien +32 (0)2 333 24 60

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

China (Shanghai) +86 (0)21 6060 7000

Deutschland +49 (0)7151 691 3004

Frankreich +33 (0)5 62 18 79 40

Griechenland +30 210 67 77 717

Indien +91 (0)80 4093 4790

Italien +39 0362 58911

Japan +81 (0)3 6632 3600

Kanada +1 (0)800 387 9699

Korea +82 2 536 7550

Mexiko +52 55 5002 3500

Niederlande +31 (0)88 00 215 00

Neuseeland 0800 601 100

Österreich +43 (0)1 402 47 72

Polen +48 22 4624032

Portugal +351 22 491 051

Schweiz +41 (0)31 818 40 90

Singapur (auch für Länder in Südostasien ohne Direktverkauf) +65 6439 3000

Slowakische Republik +421 (0)3377 254 28

Spanien +34 91 198 84 31

Südafrika +27 (0)11 807 4887

Tschechische Republik +420 (0)495 759 111

Vereinigtes Königreich +44 (0)1494 53 27 61

Weitere Informationen erhalten Sie unter teleflex.com.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow, Deknatel, DispoGrip, DispoLED, Dolphin, EquipLED, EquipLite, FibreClip, GreenLite, Hudson RCI, LMA, Maxlite, Pilling, Rüschi, Safeview, Shucman, SnapLight, TruLED, TruLite, Tru-Lite Secure, UroLift, Weck und X-Lite sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen in dieser Veröffentlichung sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung des Produkts. Es sind unter Umständen nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Überarbeitet: 10/2020.

© 2021 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

MCI 2018 0583-DE · REV 6 · 02 21 PDF